

ABBOTT-1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱:

HAV Ab (IgM)-CLIA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
BE00۰۱۵۳۷ : سری ساخت :


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۶۷۲	۰.۱۳۳	۱.۵۹۴	۱.۷۲۷	۱.۸۶	۱.۹۹۳	۲.۱۲۶	۲.۲۵۹	۲.۳۹۲

مقدار	تاریخ
۲.۱۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲.۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۲.۰۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲.۱۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲.۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۱.۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۲.۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۳
۱.۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱.۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۵
۱.۸۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱.۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۲.۰۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۲.۰۵	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲	۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱.۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
۱.۸۴	۱۴۰۰/۰۹/۰۴
۲.۰۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۶
۲.۰۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۲.۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲.۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۹

CV%: 5.558	SD: 0.113	Mean: 2.033
------------	-----------	-------------

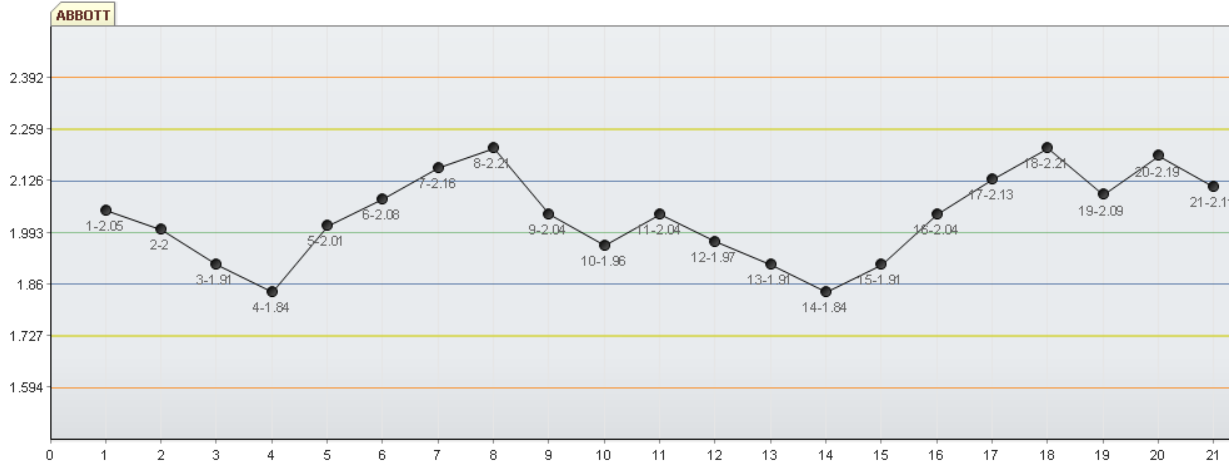

22