

عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل
۱۴۰۱/۱۰/۱۵:

سری ساخت : درون آزمایشگاه

عنوان آزمایش : Phenytoin
عنوان دستگاه : hplc


%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۰۶۲	۰.۱۴۸	۲.۱۹۴	۲.۳۴۲	۲.۴۹	۳.۶۳۸	۳.۷۸۶	۳.۹۳۴	۴.۰۸۲

مقدار	تاریخ
۳.۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۳.۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۳.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳.۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۳.۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۳.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۳.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۳.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳.۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۳.۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۳.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۳.۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۵

مقدار	تاریخ
۳.۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۳.۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۳.۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۳.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۳.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۳.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳.۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۵

CV%: 4.65	SD: 0.171	Mean: 3.671
-----------	-----------	-------------

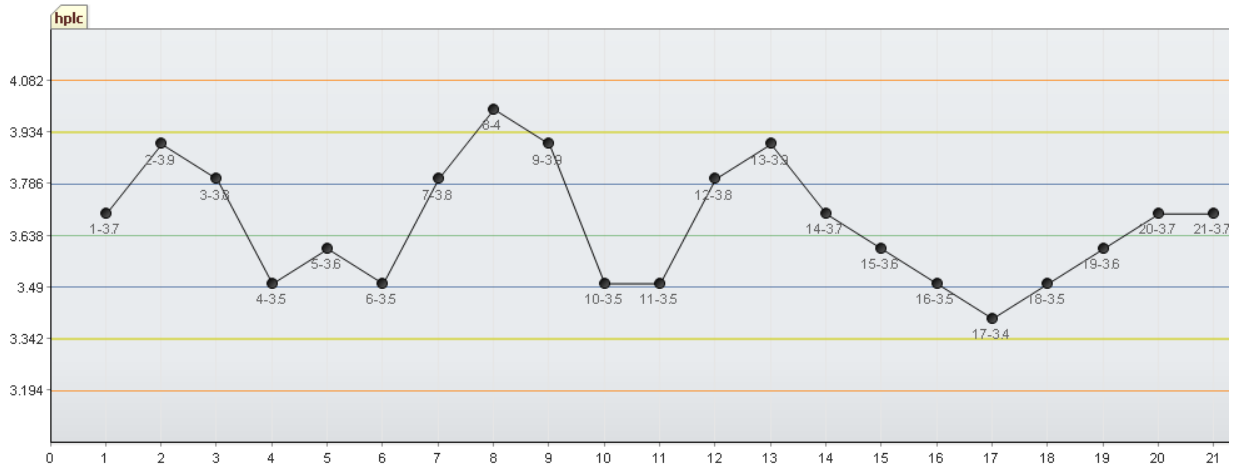

22