

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ۲-۱۴۰۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸


%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱۰.۸۴۸	۰.۵۱	۳.۱۷۳	۳.۶۸۳	۴.۱۹۳	۴.۷۰۳	۵.۲۱۳	۵.۷۲۳	۶.۲۳۳

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳.۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۴.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۵.۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۵.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۴.۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۴.۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۵.۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۵.۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۵.۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۴.۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۴	۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴.۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۴.۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۴.۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۴.۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۴.۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۴.۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۱

CV%: 11.771	SD: 0.553	Mean: 4.695
-------------	-----------	-------------

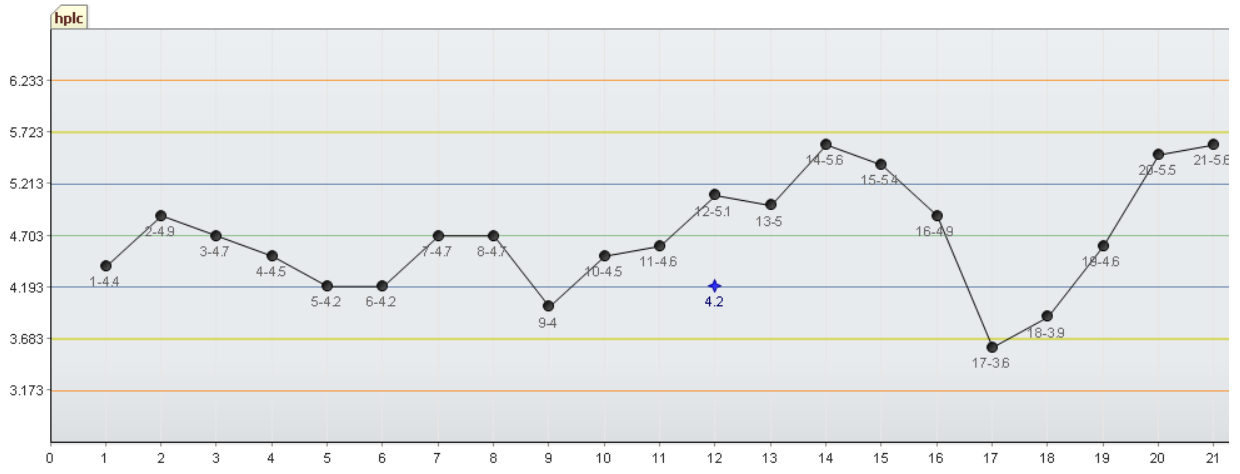

22