

Diasorin I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۵/۱۹:

سری ساخت : ۷۵۲۰۳۰۰

عنوان آزمایش : (Renin (upright  
عنوان دستگاه : لیازون


%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۷	۱.۸۹۵	۱۷.۰۵	۱۸.۹۴۵	۲۰.۸۴	۲۲.۷۳۵	۲۴.۶۳	۲۶.۵۲۵	۲۸.۴۲

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۲۲.۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۲۱.۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲۵.۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲۱.۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۲۴.۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۴.۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۲۴.۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۲۵.۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۲۴.۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۲۶.۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶

CV%: 8.069	SD: 1.912	Mean: 23.69
------------	-----------	-------------

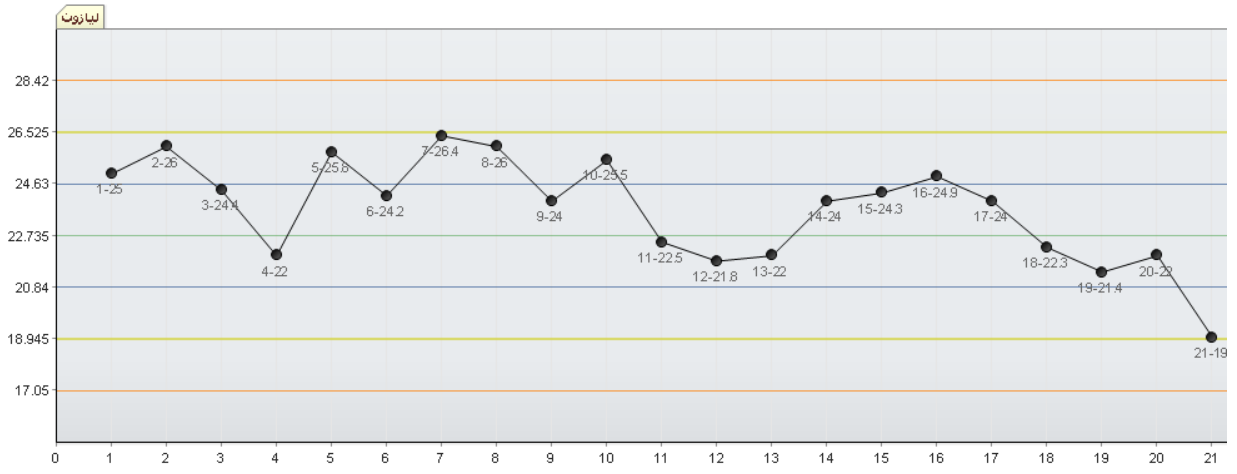

22