

عنوان کنترل : کنترل ۱  
شروع کنترل :  
۱۳۹۹/۰۲/۰۱:

سری ساخت : ۰۰-۲۵۳-۱۰/

عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH  
عنوان دستگاه : ids


%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۷.۸۹۷	۱.۰۵۱	۱۰.۱۵	۱۱.۲۰۱	۱۲.۲۵۲	۱۳.۳۰۳	۱۴.۳۵۴	۱۵.۴۰۵	۱۶.۴۵۶

مقدار	تاریخ
۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۶

مقدار	تاریخ
۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۳

CV%: 7.143	SD: 1	Mean: 14
------------	-------	----------

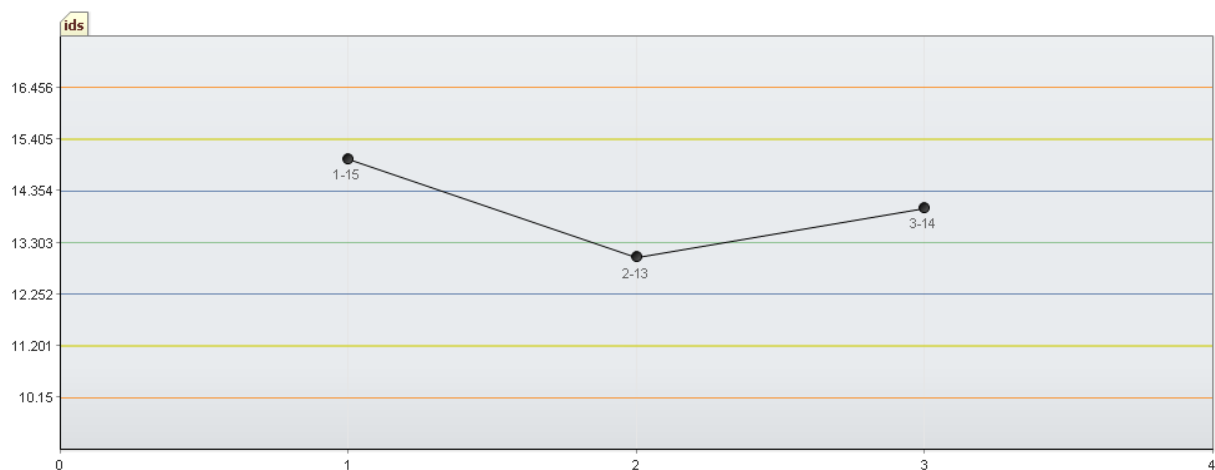

HIGH : عنوان کنترل : شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ : عنوان آزمایش : (Vitamin D(25 OH الایزایدر : عنوان دستگاه : سری ساخت : ۱۴۰۰۱

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۵.۹	۹.۱۶۷	۲۹.۹۹۹	۳۹.۱۶۶	۴۸.۳۳۳	۵۷.۵	۶۶.۶۶۷	۷۵.۸۳۴	۸۵.۰۰۱

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸

مقدار	تاریخ
۵۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۷
۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۹
۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۶
۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۷

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۴
۵۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۶۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۵۵	۱۴۰۰/۰۵/۱۶

CV%: 11.736	SD: 6.69	Mean: 57
-------------	----------	----------

