

عنوان آزمایش : Vitamin E
عنوان دستگاه : HPLC
سری ساخت :
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۰۱


%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۷۸۹	۰.۵۵۲	۹.۸۶۱	۱۰.۴۱۳	۱۱.۵۱۷	۱۲.۰۶۹	۱۲.۶۲۱	۱۳.۱۷۳

مقدار	تاریخ
۱۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۱۱.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۱۰.۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۱۱.۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۱.۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۱.۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۲.۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۱.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۱۱.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۲.۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۲.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۲.۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۱۲.۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۱۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹

CV%: 4.268	SD: 0.508	Mean: 11.9
------------	-----------	------------

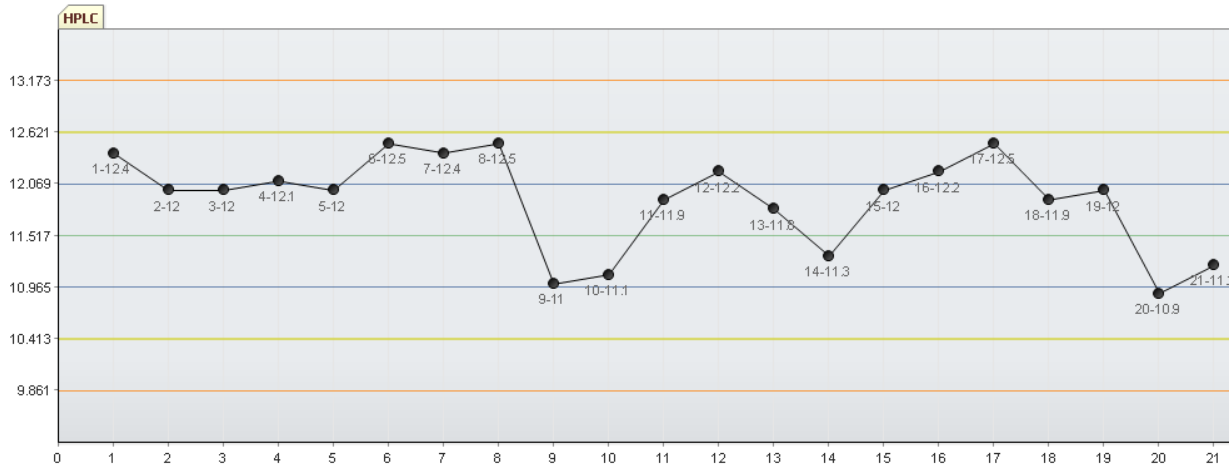

22